



Neuerungen im Laborprozess HIV


Ablösung des bisherigen HIV-Testkonzepts durch die neue HIV-Testrichtlinie per 01.01.2025

Die HIV-Bestätigungsdiagnostik erfolgt neu laborintern. Über die erste Bestätigungsanalyse wird in der Regel innerhalb von 2 Arbeitstagen berichtet.

Die wichtigsten Änderungen

- Im Idealfall wird die HIV-Diagnostik aus dem **EDTA-Plasma** durchgeführt.
- Bei einem reaktiven Resultat wird eine HIV-1 RNA PCR gemacht.
- Reaktive Screening-Tests werden sowohl mittels PCR als auch mittels AK-Differenzierung überprüft, bevor ein endgültig negatives Resultat berichtet wird.
- Screening und Bestätigung erfolgen aus der gleichen Probe intern bei Dr. Risch.
- Bei Verdacht auf eine Primoinfektion wird zeitgleich mit dem HIV-Screeningtest eine HIV-1 RNA PCR durchgeführt. Dafür benötigen wir zwingend EDTA-Blut.
- Das Vorgehen entspricht der neuen HIV-Testrichtlinie, welche am 13.11.2024 vom BAG veröffentlicht wurde.

Diagnostik im Labor

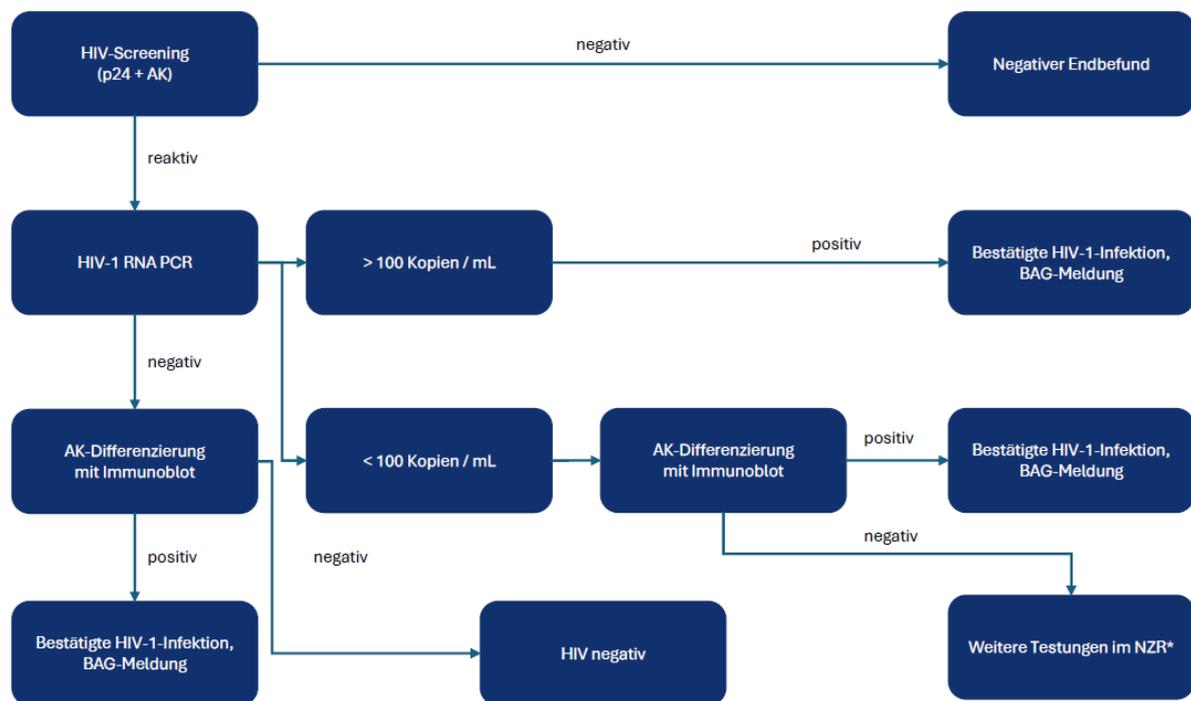

* Nationales Zentrum für Retroviren

Analyse	HIV-1/2-Screening (HIV)
Material	EDTA-Plasma
Kosten	Gemäss Analysenliste

