



## Nouveautés dans le processus de laboratoire VIH


Remplacement du concept de test VIH actuel par la nouvelle directive sur le dépistage du VIH au 01.01.2025

Le diagnostic de confirmation du VIH a désormais lieu en interne au laboratoire. La première analyse de confirmation fait généralement l'objet d'un rapport dans les 2 jours ouvrables.

### Les principales modifications

- Dans l'idéal, le diagnostic VIH est effectué à partir du **plasma EDTA**.
- En cas de résultat réactif, une PCR ARN VIH-1 a lieu.
- Les tests de dépistage réactifs sont vérifiés tant au moyen de la PCR qu'avec la différenciation des anticorps.
- Le dépistage et la confirmation se font en interne chez Dr Risch, à partir du même échantillon.
- Si une primo-infection est suspectée, une PCR ARN VIH-1 est réalisée en même temps que le test de dépistage du VIH. Pour cela, nous avons besoin impérativement de sang EDTA.
- La procédure est conforme à la nouvelle directive sur le dépistage du VIH, qui a été publiée par l'OFSP le 13.11.2024.

### Diagnostic au laboratoire

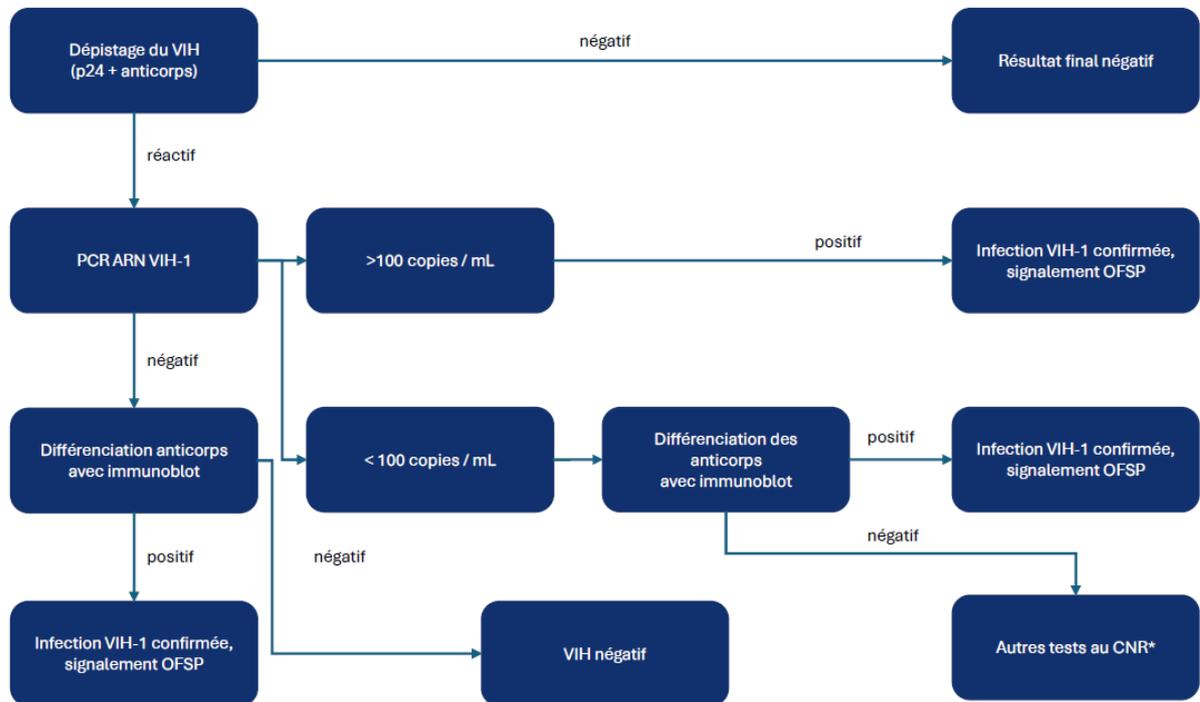

\* Centre National de Rétrovirus

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Analyse  | VIH-1/2-screening (VIH)     |
| Matériel | plasma EDTA                 |
| Coûts    | selon la liste des analyses |

